


备注


修 订				
区域	修订	说明	日期	作者
	A	新品导入	2023/11/7	张洋洋



Intraoral Scanner
ST200E
3.6V/3500mAh

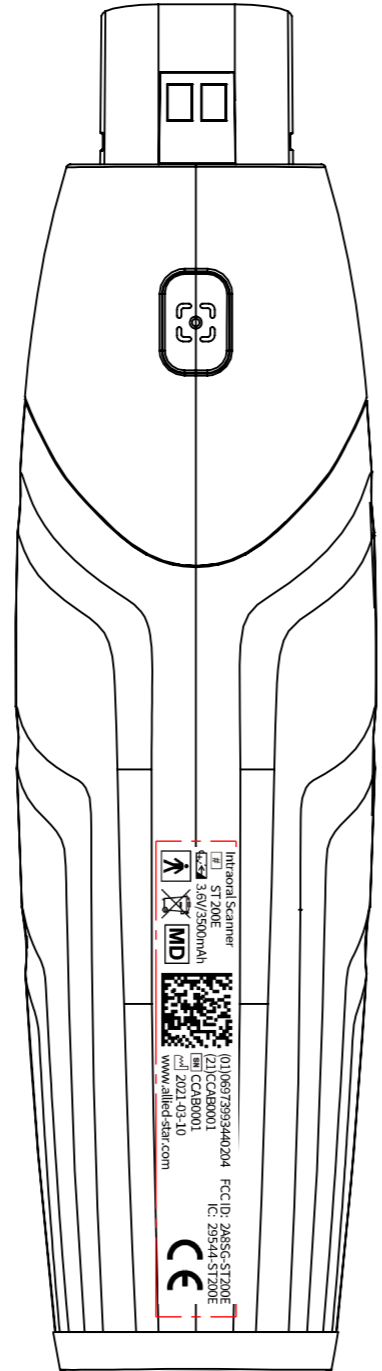

(01)06973993440204 FCC ID: 2A8SG-ST200E
(21)CCAB0001 IC: 29544-ST200E
SN CCAB0001
2021-03-10
www.allied-star.com



Intraoral Scanner
ST200E
3.6V/3500mAh



(01)06973993440204 FCC ID: 2A8SG-ST200E
(21)CCAB0001 IC: 29544-ST200E
SN CCAB0001
2021-03-10
www.allied-star.com



技术要求:

- 1、未注图纸尺寸参照：AI文件。
- 2、未注公差参照：GB/T1804-2000 m。
- 3、镗雕不得有重影、倾斜、爆皮、毛糙等外观问题。
- 4、PI码、SN号、生产日期，需要按产品更新，二维码重新生成。
- 5、首样确认后，WI制定工艺参数，后期按此执行。

姓名	周晟	日期	2024/3/22	
校对	李红杰	日期	2024/3/22	
图样名称	Straumann 探月 手持件镗雕 国外版			
图纸标准	ASME Y14.5-2018			
默认单位	mm			
图幅	A3	图样代号	AP2347	版本
				A
比例	1:1			页数 1 OF 1

