


标准书名		印刷部品规格书			公差等级		A级	B级	C级
					基本尺寸				
注 意 事 项	● 图中 * 记号表示该尺寸为重点管控尺寸。				5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15	
	● 量产前样品请先取得设计相关人员确认				10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20	
	● 使用模具在二具以上时各模具之检定品。				20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25	
● 交货时希望在变更时，须事先取得业务相关人员之承认									
▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。									

## S36骨传导耳机-黑配色

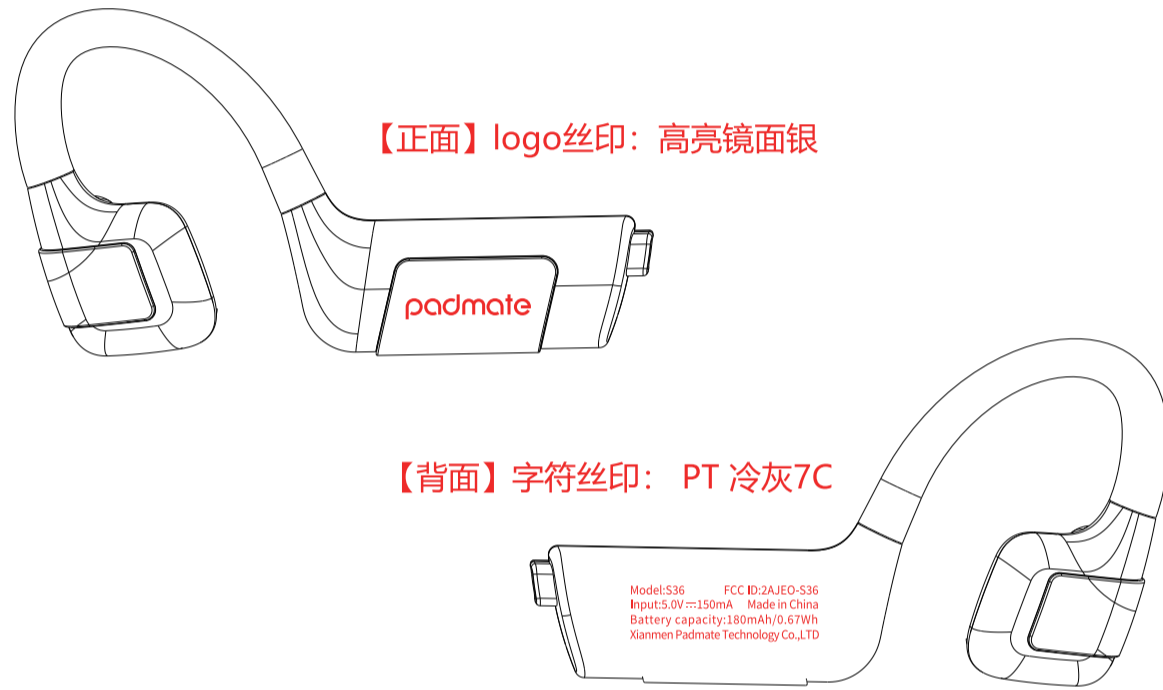

丝印版本		派美特	2023/08/17				丝印颜色		
部品名	耳机	使用机种	日期	制图	确认	承认	产品颜色		
序号	原版本	现有版本	变更内容						
1									
2									
3									
厦门市派美特科技有限公司				页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例
				1/1	A4		A	mm	1:1