


# GEEKOM



USB 3.2 Gen2 Port  
USB 3.2 Gen2-Port  
USB 3.2 Gen2-poor  
Puerto USB 3.2 Gen2  
Port USB 3.2 Gen2  
Porta USB 3.2 Gen2  
Порт USB 3.2.2 nok  
USB 3.2-порт  
USB 3.2 Gen2 端口

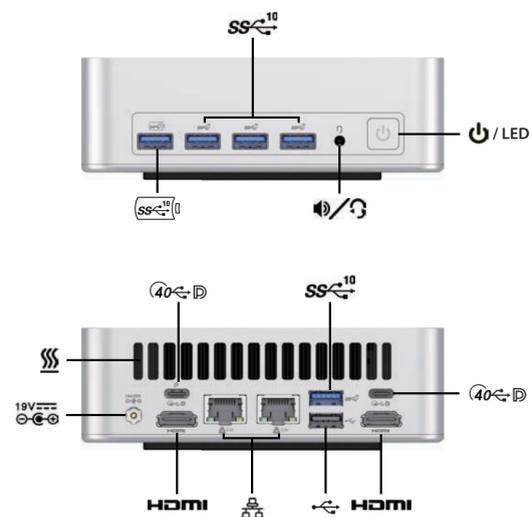

Speaker/Headset  
Lautsprecher/Headset  
Högtalare/Headset  
Luidspreker/Headset  
Altavoces / Auriculares  
Haut-parleurs/Casque-micro  
Altoparlante/Cuffia  
Динамик/гарнитура  
スピーカ/ヘッドフォン  
扬声器/耳机



Power Button/LED  
Netztaete/LED  
Strömknapp/LED  
Aan/uitknop/LED  
Botón / LED de Encendido  
Bouton d'Alimentation/LED  
Pulsante di Alimentazione/LED  
Кнопка питания/светодиод  
電源ボタン/LED  
電源按钮/LED



USB4+DP Port  
USB4+DP-Port  
USB4+DP-Port  
USB4+DP-poor  
Puerto USB4+DP  
Port USB4+DP  
Porta USB4+DP  
Порт USB4+DP  
USB4+DP-порт  
USB 4+ DP端口



HDMI Port  
HDMI-Port  
HDMI-Port  
HDMI-poor  
Puerto HDMI  
Port HDMI  
Porta HDMI  
Порт HDMI  
HDMI-порт  
HDMI端口



USB 2.0 Port  
USB 2.0-Port  
USB 2.0-port  
USB 2.0-poor  
Puerto USB 2.0  
Puerto USB 2.0  
Porta USB 2.0  
Порт USB 2.0  
USB 2.0-порт  
USB 2.0 端口








USB 3.2 Gen2+PD Port  
USB 3.2 Gen2+PD-Port  
USB 3.2 Gen2+PD-Port  
USB 3.2 Gen2+PD-poor  
Puerto USB 3.2 Gen2+PD  
Port USB 3.2 Gen2+PD  
Porta USB 3.2 Gen2+PD  
Порт USB 3.2.2 nok + PD  
USB 3.2 Gen2 + PD-порт  
USB 3.2 Gen2+PD端口



Ethernet Port  
Ethernet-Port  
Ethernet Port  
Ethernet-poor  
Puerto Ethernet  
Port Ethernet  
Porta Ethernet  
Порт Ethernet  
イーサネットポート  
以太网端口



Electric Power Inlet  
Stromeingang  
Elektriskt anslutning in  
Voedingsaansluiting  
Entrada de Alimentación Eléctrica  
Entrée d'Alimentation Vlectrique  
Ingresso di Alimentazione  
Вход для электропитания  
電源 コンセント  
电源插口

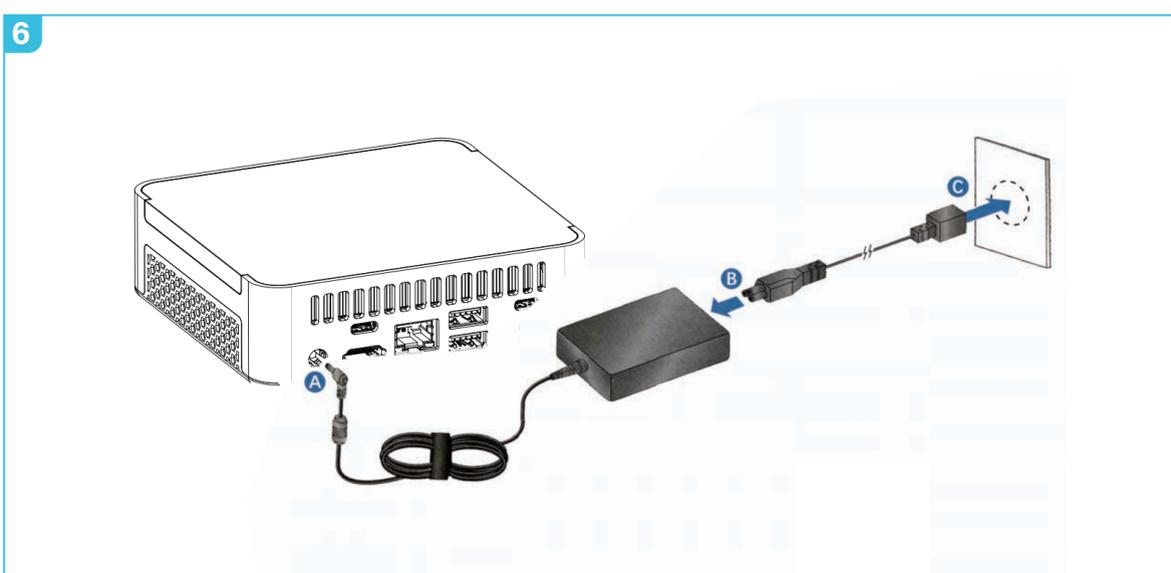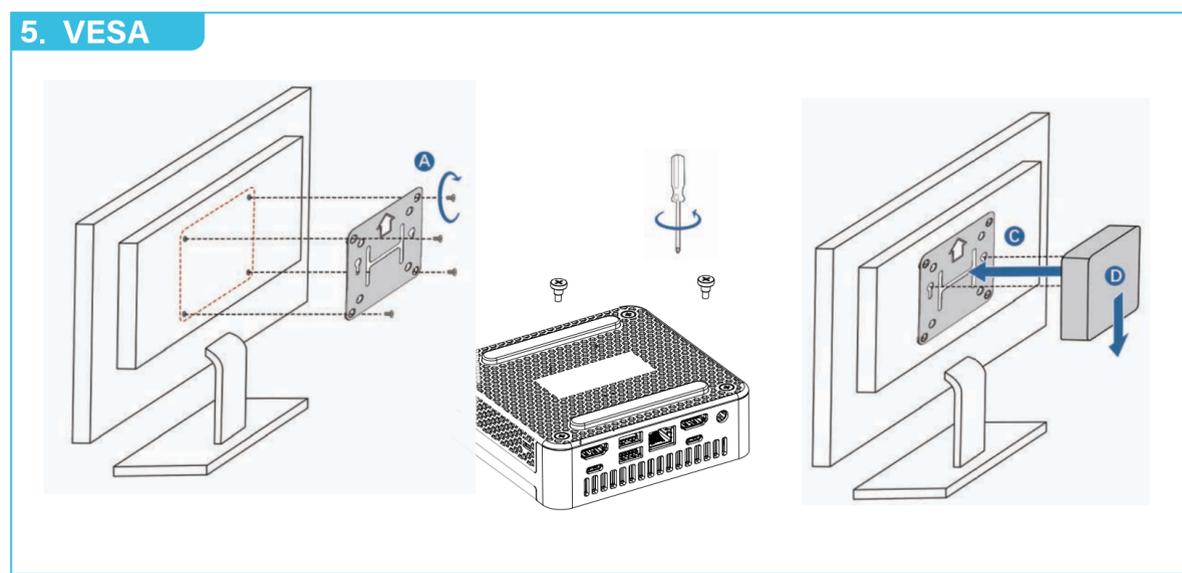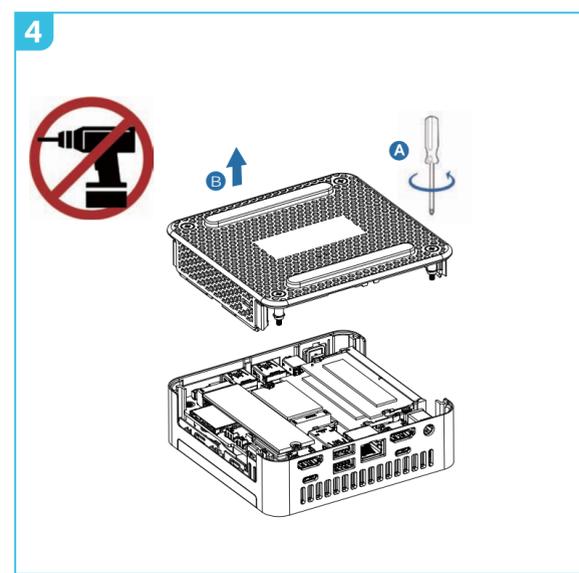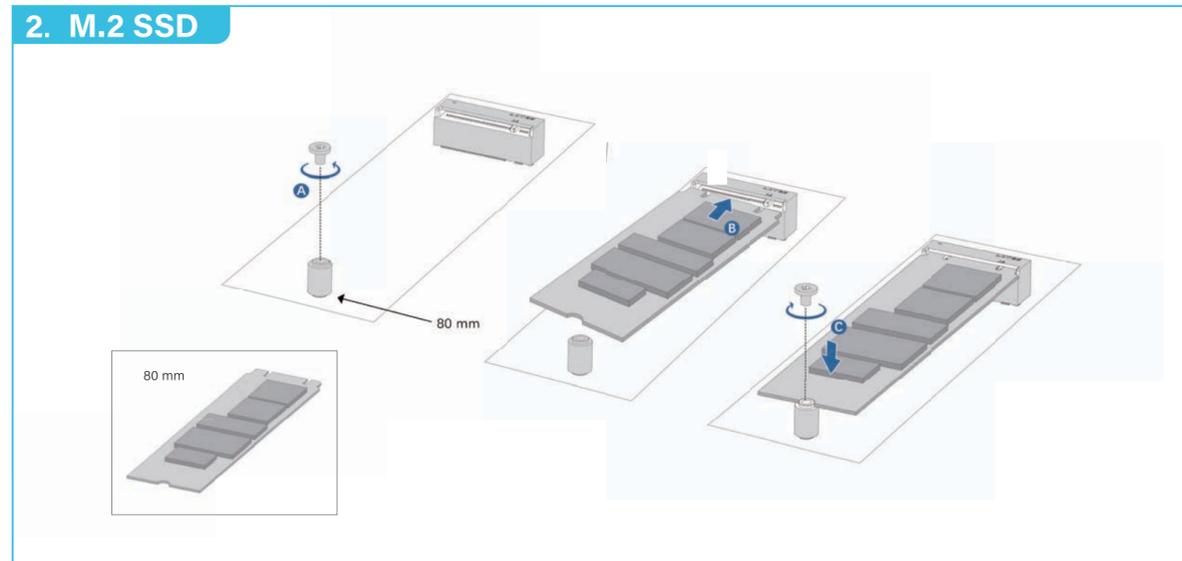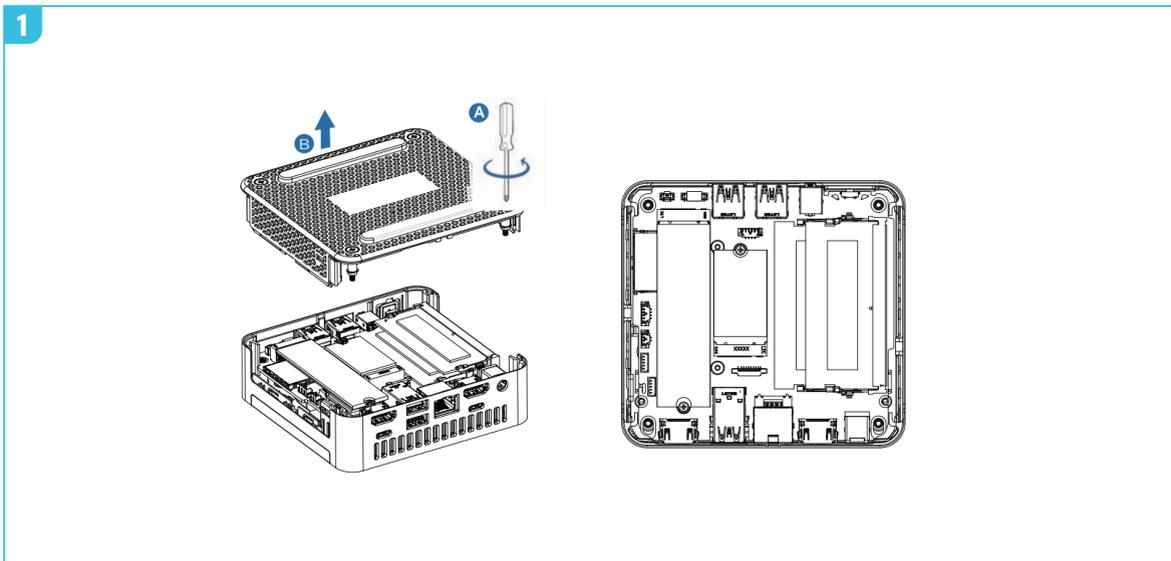

### Safety and Caution Information

- AC Power Adapter:** Risk of electric shock, fire, or burn if using an AC adapter other than the one provided with this device. Indoor use only and in dry locations. Device must only be repaired by a professional. Do not open enclosure. The adapter is rated for use between 0 °C and 35 °C (32 °F and 95 °F). Connect only to a properly wired and grounded outlet.
- Battery:** Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.
- Power Adapter:** Failure to use the included power adapter shall violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.
- Temperature:** This device is intended for use in ambient temperatures between 0 °C and 35 °C (32 °F and 95 °F). Avoid using or storing next to heat sources, in direct sunlight, or outside the intended temperature ranges.
- Medical:** This device may interfere with the operation of some pacemakers, hearing aids or other medical devices. To reduce the risk, maintain a separation distance of 20 cm (8 inches) between the device and the medical device. Refer to the medical device for additional information.
- Modification:** Modification of the wireless solution, thermal solution, device components or enclosure shall violate regulatory compliance requirements and may induce safety hazards.

### Sicherheits- und Warnhinweise

- Netzstromadapter:** Es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand- oder Verbrennungsgefahr, wenn ein anderer als der im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzstromadapter eingesetzt wird. Nur zum Einsatz in Gebäuden und in trockenen Umgebungen. Das Gerät darf nur von einem befugten Techniker repariert werden. Gehäuse nicht öffnen. Der Adapter ist zur Verwendung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Nur an eine ordnungsgemäß verkabelte und geerdete Steckdose anschließen.
- Batterie:** Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen unsachgemäßen Akkutypen ersetzt wird. Akkus sollten soweit möglich zum Recycling abgegeben werden. Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sind alle geltenden örtlichen Umweltschutzvorschriften zu beachten.
- Netzstromadapter:** Die Nichtverwendung des im Lieferumfang enthaltenen Netzstromadapters gilt als Verstoß gegen behördliche Compliance-Vorschriften und kann eine Gefährdung des Anwenders darstellen.
- Temperatur:** Dieses Gerät ist zur Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C vorgesehen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung in der Nähe von Heizquellen, in direkter Sonnenbestrahlung oder in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb der vorgesehenen Werte.
- Medizinisch:** Das Gerät kann Interferenzen im Betrieb von bestimmten Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen medizinischen Geräten verursachen. Zur Risikominderung sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem medizinischen Gerät eingehalten werden. Weitere Informationen können Sie den Anleitungen zum medizinischen Gerät entnehmen.
- Änderungen:** Eine Änderung der Wireless-Lösung, der Kühlungslösung, der Gerätekomponenten oder des Gehäuses verstößt gegen die Compliance-Vorschriften und kann zu Gefährdungen führen.

# 背面

## 安全と注意

### Säkerhets- och försiktighetsinformation

**⚠️ Nätadapter:** Risk för elchock, brand eller brännskada vid användning av annan nätadapter än den som tillhandahålls med denna enhet. Endast inomhusanvändning och på torra platser. Enheten får endast repareras av yrkesman. Öppna inte höljet. Adaptern är märkt för användning mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Anslut endast till jordat vägguttag med korrekt ledningsdragning.

**⚠️** Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ. Batterier ska återvinnas där så är möjligt. Avyttring av batterier måste ske i enlighet med lokala miljöförfordningar.

**⚠️** Underlåtande att använda den medföljande nätadaptern innebär överträdelser av krav på efterlevnad och kan föranleda säkerhetsrisker.

**⚠️ Temperatur:** Denna enhet är avsedd för användning i omgivningstemperatur mellan 0 °C och 35 °C (32 °F och 95 °F). Undvik användning eller förvaring i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller utanför avsett temperaturintervall.

**⚠️ Medicinskt:** Denna enhet kan orsaka störning i driften av vissa pacemakrar, hörapparater och andra medicinska anordningar. Minska risken genom att upprätthålla ett separationsavstånd på 20 cm (8 tum) mellan enheten och den medicinska anordningen. Härvisa till den medicinska anordningen för ytterligare information.

**⚠️ Modifiera:** Modifiering av den trådlösa lösningen, termal lösning, enhetskomponenter eller hölje kan innebära överträdelser av krav på överensstämmelse och föranleda säkerhetsrisker.

## Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza

## Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza

## Informazioni di avvertenza e sulla sicurezza

**⚠️ Adattatore di alimentazione CA:** se si usa un adattatore CA diverso da quello fornito con il dispositivo, si corre il rischio di causare scosse elettriche, incendi o ustioni. Utilizzare esclusivamente in ambienti interni e asciutti. Il dispositivo deve essere riparato solo da professionisti. Non aprire l'enclosure. L'adattatore è classificato per l'uso con temperature comprese tra 0 °C e 35 °C. Collegarlo solo a una presa che sia correttamente collegata e dotata di messa a terra.

**⚠️** Se la batteria è sostituita con una di tipo non corretto si corre il rischio di causare un'esplosione. Le batterie devono essere riciclate, se possibile. Lo smaltimento delle batterie usate deve essere effettuato conformemente alla normativa ambientale locale.

**⚠️** Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione incluso costituisce una violazione dei requisiti di conformità legali e può esporre l'utente a pericoli per la sicurezza.

**⚠️ Temperatura:** questo dispositivo è destinato all'uso con temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 35 °C. Evitare di utilizzare o conservare il dispositivo accanto a fonti di calore, sotto la luce diretta del sole o in ambienti con temperature esterne all'intervallo delle temperature previste.

**⚠️ Settore medico:** questo dispositivo può interferre con il funzionamento di alcuni pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici. Per ridurre il rischio, mantenere il dispositivo a una distanza di 20 cm dal dispositivo medico. Per ulteriori informazioni fare riferimento al dispositivo medico.

**⚠️ Modifica:** la modifica della soluzione wireless, della soluzione termica, dei componenti o dell'enclosure del dispositivo causa la violazione dei requisiti di conformità con le normative e potrebbe creare pericoli per la sicurezza.

## Información sobre seguridad y precauciones

## Información sobre seguridad y precauciones

### FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

## Información sobre seguridad y precauciones

## Información sobre seguridad y precauciones

Click Bluetooth, add Bluetooth device, open Add Device, select Bluetooth, click to select the Bluetooth device you want to connect to, and pair it with your phone or computer.

### Informatie over veiligheid en waarschuwingen

**⚠️ AC-adapter:** er bestaat een risico op een elektrische schok, brand of brandwonden als een andere AC-adapter wordt gebruikt dan de adapter die is geleverd bij dit apparaat. Adapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en op droge locaties. Apparaat mag alleen worden gerepareerd door een professional. Open de behuizing niet. De adapter is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Sluit de adapter aan op een correct bekabeld en geaard stopcontact.

**⚠️** Er bestaat een risico op ontploffing indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Recycle de batterijen indien mogelijk. Het wegwerpen van gebruikte batterijen moet gebeuren in overeenstemming met lokale milieuwetgeving.

**⚠️** Het gebruik van een andere adapter dan de inbegrepen voedingsadapter zal tot het overtreden van wettelijke conformiteitseisen leiden en kan ook tot een gevaarlijke situatie voor de gebruiker leiden.

**⚠️ Temperatur:** dit apparaat is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 35 °C. Vermijd gebruik of opslag dicht bij warmtebronnen, in direct zonlicht of buiten de geschikte temperatuurbereiken.

**⚠️ Medisch:** dit apparaat kan interfereren met de werking van sommige pacemakers, hoorapparaten of andere medische apparaten. Zorg dat er altijd een afstand van 20 cm is tussen het apparaat en het medische apparaat om het risico te verminderen. Raadpleeg de documentatie bij het medische apparaat voor meer informatie.

**⚠️ Aanpassingen:** aanpassingen aan de draadloze oplossing, componenten van het apparaat of de behuizing kunnen leiden tot schending van de wettelijke conformiteitseisen en kunnen gevaar veroorzaken.

## Información sobre seguridad y precauciones

## Información sobre seguridad y precauciones

### Информация о безопасности и предостережения

**⚠️** Адаптер питания переменного тока: Опасность поражения электрическим током, пожара или ожога при использовании адаптера переменного тока, отличного от прилагаемого к устройству. Использовать только внутри помещений и в сухих местах. Ремонт устройства должен выполняться только профессионалом. Не открывайте корпус. Адаптер рассчитан на использование при температуре от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Подключайте только к правильно подключенной и заземленной розетке.

**⚠️** Опасность взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа. Батареи должны быть переработаны, если это возможно. Утилизация использованных батарей должна производиться в соответствии с местными нормами охраны окружающей среды.

**⚠️** Неиспользование прилагаемого адаптера питания нарушает нормативные требования и может подвергнуть пользователя опасности.

**⚠️** Температура: Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C (32 °F - 95 °F). Избегайте использования или хранения рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами или вне предусмотренных температурных диапазонов.

**⚠️** Медицина: Это устройство может мешать работе некоторых кардиостимуляторов, слуховых аппаратов или других медицинских приборов. Для снижения риска соблюдайте расстояние 20 см (8 дюймов) между устройством и медицинским прибором. Дополнительную информацию см. на медицинском приборе.

**⚠️** Внесение изменений: Модификация беспроводного решения, теплового решения, компонентов устройства или корпуса нарушает нормативные требования и может привести к возникновению угрозы безопасности.

## Información sobre seguridad y precauciones

處理器: AMD Ryzen™ 8000 AMD Ryzen™ 7000 處理器

顯卡:AMD Radeon™ Graphics

RAM品牌:Lexar/Crucial (量產排這個)

內存: 雙通道DDR5 SOMDIMM

存儲: 1xSSD (M.2 NVMe)

操作系統: Windows 11

無線連接:藍芽5.2: WI-FI 6E

乙太網: 2500 Mbps LAN

電源輸入參數: 19V 6.32A 120W

### Información sobre seguridad y precauciones

**⚠️ Adaptador de corriente CA:** Existe riesgo de choque eléctrico, incendio o quemaduras si se utiliza un adaptador CA que no sea el suministrado con este dispositivo. Uso en interiores y lugares secos solamente. El dispositivo sólo puede ser reparado por un profesional. No abra la carcasa. El adaptador está certificado para uso entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Conéctelo solamente a un tomacorriente debidamente cableado y con descarga a tierra.

**⚠️** Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza con una incorrecta. Las baterías deben reciclarse, cuando sea posible. Debe desechar las baterías usadas según las regulaciones locales para proteger el medio ambiente.

**⚠️** No utilizar el adaptador de corriente incluido representa una violación de los requisitos de conformidad regulatoria y podría exponer al usuario a riesgos de seguridad.

**⚠️ Temperatura:** Este dispositivo está destinado a usarse en temperaturas ambiente de entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F). Evite usar o guardar el dispositivo junto a fuentes de calor, a la luz directa del sol o fuera de los rangos de temperatura indicados.

**⚠️ Uso médico:** Este dispositivo puede interferir con el funcionamiento de algunos marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos. Para reducir el riesgo, mantenga una distancia de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el dispositivo y el dispositivo médico. Consulte la información del dispositivo médico para obtener más detalles.

**⚠️ Modificación:** La modificación de la solución inalámbrica, la solución térmica, los componentes del dispositivo o la caja constituyen una violación de los requisitos de conformidad y podrían generar riesgos de seguridad.

## Información sobre seguridad y precauciones

## Información sobre seguridad y precauciones

### 安全と注意

**⚠️** 【AC電源アダプタ】付属のACアダプタ以外を使用すると、感電や火災、火傷の危険があります。屋内の乾燥した場所で使用してください。修理は必ず専門業者に任せてください。解体しないでください。このアダプタは0～35 °C (32 °F～95 °F)での使用を想定した設計になっています。正しく配線、アースされたコンセントのみに接続してください。

**⚠️** 誤った種類の電池を入れると、爆発する恐れがあります。電池は可能な限りリサイクルしてください。使用済みの電池を廃棄する際は、地域の環境規制に従ってください。

**⚠️** 付属の電源アダプタを使用しないことは規制違反であり、利用者を危険にさらす可能性があります。

**⚠️** 【温度】このデバイスは、0～35 °C (35～95°F)の室温で使用することを想定した設計になっています。熱源の近くや直射日光、または想定温度範囲外での使用や保管は避けてください。

**⚠️** 【医療】このデバイスは、一部のペースメーカーや補聴器、その他の医療機器に影響を及ぼすことがあります。そのリスクを減らすため、本機と医療機器の間に20cmの距離を確保してください。さらに詳しい情報については、医療機器をご確認ください。

**⚠️** 【変更】ワイヤレス、サーマル、デバイス部品等の改造は、規制違反に当たり、危険につながる可能性があります。

### Information sur la sécurité et consignes de prudence

**⚠️ Bloc d'alimentation secteur :** toute utilisation d'un bloc d'alimentation secteur autre que celui qui est fourni avec l'appareil risque de provoquer des chocs électriques, incendies ou brûlures. N'utilisez qu'à l'intérieur et dans des endroits secs. L'appareil doit être réparé exclusivement par un professionnel. N'ouvrez pas le boîtier. Le bloc d'alimentation doit être utilisé entre 0 °C et 35 °C (32 °F et 95 °F). Branchez-le uniquement à une prise correctement câblée et mise à la terre.

**⚠️** Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Les batteries doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des batteries usagées doit être réalisée conformément aux réglementations environnementales.

**⚠️** Tout manquement à l'utilisation de l'adaptateur secteur inclus constituera une violation des exigences de conformité à la réglementation et peut mettre en danger l'utilisateur.

**⚠️ Température :** cet appareil est prévu pour être utilisé à une température ambiante située entre 0 °C et 35 °C (-32 °F et 95 °F). Évitez de l'utiliser ou de l'entreposer à proximité de sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou hors de la plage de températures prévue.

**⚠️ Appareils médicaux :** il est possible que cet appareil affecte le fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques, appareils auditifs ou autres instruments médicaux. Pour réduire les risques, maintenez une distance de séparation de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et l'appareil médical. Reportez-vous à la documentation de l'instrument médical pour davantage d'informations.

**⚠️ Modification :** toute modification de la solution sans fil, de la solution thermique, des composants de l'appareil ou du boîtier constitue une violation des exigences de conformité à la réglementation et peut présenter des risques d'accident.

## Information sur la sécurité et consignes de prudence

## Information sur la sécurité et consignes de prudence

### 安全警告信息

**⚠️ 交流电源适配器:**使用非随设备提供的交流电源适配器会有触电、火灾或灼伤的风险。仅适用于室内和干燥的环境。仅限专业人员修理设备。不要打开外壳。适配器的额定温度为0°C到35°C (32°F到95°F) 之间。仅连接到正确连线 and 接地的电源插座。

**⚠️** 如果电池更换不当, 会有爆炸的危险。尽可能回收电池。废旧电池的处理必须符合当地环境法规。**⚠️** 不使用附带的电源适配器会违反规范要求, 并可能使用户面临安全风险。

**⚠️ 温度:** 此设备适合在0°C到35°C (32°F到95°F) 的环境温度中使用。避免在热源附近、阳光直射下或在指定温度范围之外使用或存储。

**⚠️ 医疗:** 此设备可能会对某些起搏器、助听器或其他医疗设备的操作造成干扰。为降低此风险, 请在此设备和医疗设备之间保持20厘米 (8英寸) 的间隔距离。请参阅医疗设备的说明以了解更多信息。

**⚠️ 修改:** 对无线解决方案、散热方案、设备组件或外壳进行修改会违反规范要求, 并导致安全风险。

For TELEC

Model name: AX8 Max, AE7 Max, AE8 Max, AE9 Max, AE10 Max, AX7 Max, AX9 Max, AX10 Max, A7 Max, A8 Max, A9 Max, A10 Max, IT1 Mega, IT2 Mega, IT3 Mega, GT1 Mega, GT2 Mega, GT3 Mega, XT1 Mega, XT2 Mega, XT3 Mega

For IC

HVIN	PMN	Model name
AX7 Max	AX7 Max	AX7 Max
	AX9 Max	AX9 Max
AX8 Max	AX8 Max	AX8 Max
	GT13 Max	GT13 Max
	GT14 Max	GT13 Max
GT1 Mega	GT1 Mega	GT1 Mega
	GT2 Mega	GT2 Mega

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et la carrosserie.

Operation of this device is restricted to indoor use only. (5150-5350MHz)

Le fonctionnement de cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement. (5150-5350MHz)