

Appendix A_Test Equipment CERTIFIED DOCUMENTS

열 람 용

This certificate may not be reproduced
other than in full except with
permission of the issuing laboratory.

교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022668

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025661

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415233

- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR19
- 기기번호 (Serial Number) : SAX 771

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2023.03.14

차기교정예정일자 : 2024.03.14

(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.8 ± 0.1) °C - 습도(Humidity) : (46 ± 3) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT/E8257D	MY46130629	2023/10/26	(주)에이치시티
EPM SERIES POWER METER	AGILENT/E4419B	GB42420565	2023/10/26	(주)에이치시티
POWER SENSOR	AGILENT/8487A	MY41092450	2023/12/19	Keysight Technologies Inc
POWER SENSOR	KEYSIGHT/V8486A	MY56330017	2023/12/13	Keysight Technologies
WR-19 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S19MS-A	160516-1	2023/07/19	(주)에이치시티
PAX SIGNAL ANALYZER	AGILENT/N9030A	US51350310	2024/03/13	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k = 2 (Confidence level about 95 %, k = 2)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) 고 형 재 (서명)	직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager) 성명 (Name) 김 광 철 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2023. 03. 15

한국인정기구 인정

Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사

President, HCT Co., Ltd.



※ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(파부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

※ 고객전용사이트(<http://www.callab.co.kr>)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT




성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022668

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025661

페이지(page) : 2 of 3

1. Conversion Loss Graph

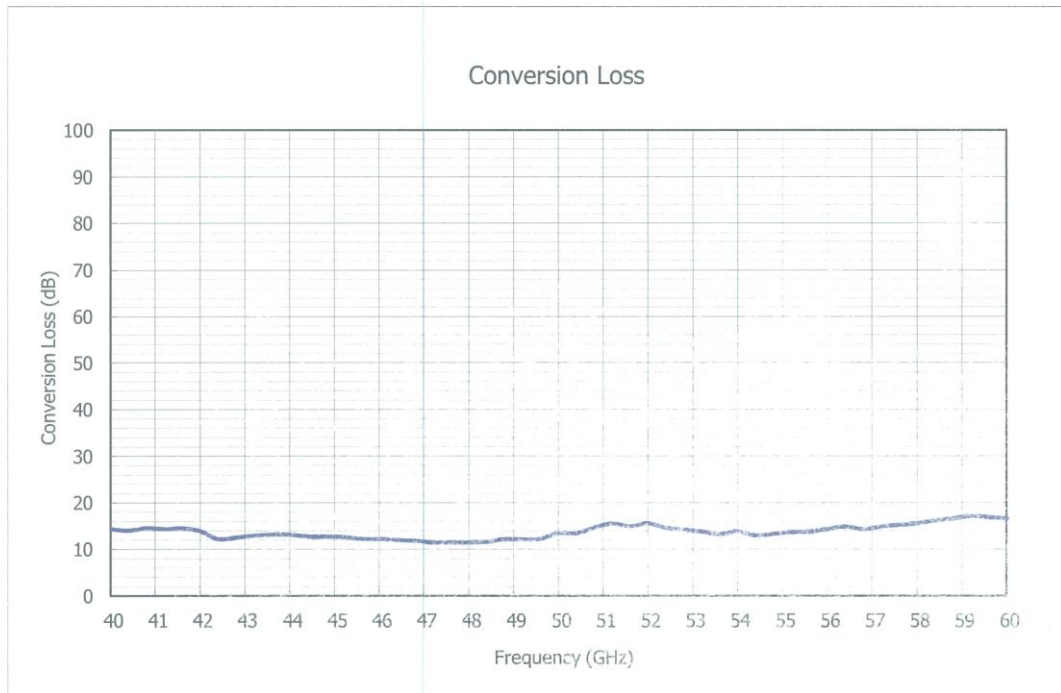

[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 8, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022668

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025661

페이지(page) : 3 of 3

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
40.0	14.38	0.82	50.4	13.38	0.82
40.4	13.98	0.82	50.8	14.61	0.82
40.8	14.58	0.82	51.2	15.51	0.82
41.2	14.32	0.82	51.6	14.85	0.82
41.6	14.53	0.82	52.0	15.57	0.82
42.0	13.87	0.82	52.4	14.53	0.82
42.4	12.20	0.82	52.8	14.17	0.82
42.8	12.49	0.82	53.2	13.75	0.82
43.2	12.94	0.82	53.6	13.23	0.82
43.6	13.17	0.82	54.0	13.76	0.82
44.0	13.16	0.82	54.4	12.94	0.82
44.4	12.72	0.82	54.8	13.30	0.82
44.8	12.72	0.82	55.2	13.63	0.82
45.2	12.63	0.82	55.6	13.76	0.82
45.6	12.21	0.82	56.0	14.29	0.82
46.0	12.23	0.82	56.4	14.83	0.82
46.4	11.96	0.82	56.8	14.26	0.82
46.8	11.84	0.82	57.2	14.85	0.82
47.2	11.43	0.82	57.6	15.20	0.82
47.6	11.50	0.82	58.0	15.56	0.82
48.0	11.47	0.82	58.4	16.15	0.82
48.4	11.58	0.82	58.8	16.58	0.82
48.8	12.14	0.82	59.2	17.15	0.82
49.2	12.07	0.82	59.6	16.86	0.82
49.6	12.23	0.82	60.0	16.57	0.82
50.0	13.46	0.82	-	-	-

끝.

열 람 용

This certificate may not be reproduced
other than in full except with
permission of the issuing laboratory.

교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022667

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025660

페이지(page) : 1 of 4

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415873

- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR12
- 기기번호 (Serial Number) : SAX773

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2023.03.22

차기교정예정일자 : 2024.03.22

(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.7 ± 0.4) °C - 습도(Humidity) : (46 ± 3) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT/E8257D	MY46130629	2023/10/26	(주)에이치시티
EPM SERIES POWER METER	AGILENT/E4419B	GB42420565	2023/10/26	(주)에이치시티
POWER SENSOR	KEYSIGHT/V8486A	MY56330017	2023/12/13	Keysight Technologies
POWER SENSOR	KEYSIGHT/W8486A	MY56370005	2024/01/10	Keysight Technologies
WR-12 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S12MS-A	160419-1	2023/07/19	(주)에이치시티
PAX SIGNAL ANALYZER	AGILENT/N9030A	US51350310	2024/03/13	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, $k = 2$ (Confidence level about 95 %, $k = 2$)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) 강 석 훈	직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager)
		성명 (Name) 김 광 철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2023. 03. 22

한국인정기구 인정

Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사

President, HCT Co., Ltd.



※ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.


※ 고객전용사이트(<http://www.callab.co.kr>)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교정결과

CALIBRATION RESULT




성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022667

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025660

페이지(page) : 2 of 4

1. Conversion Loss Graph

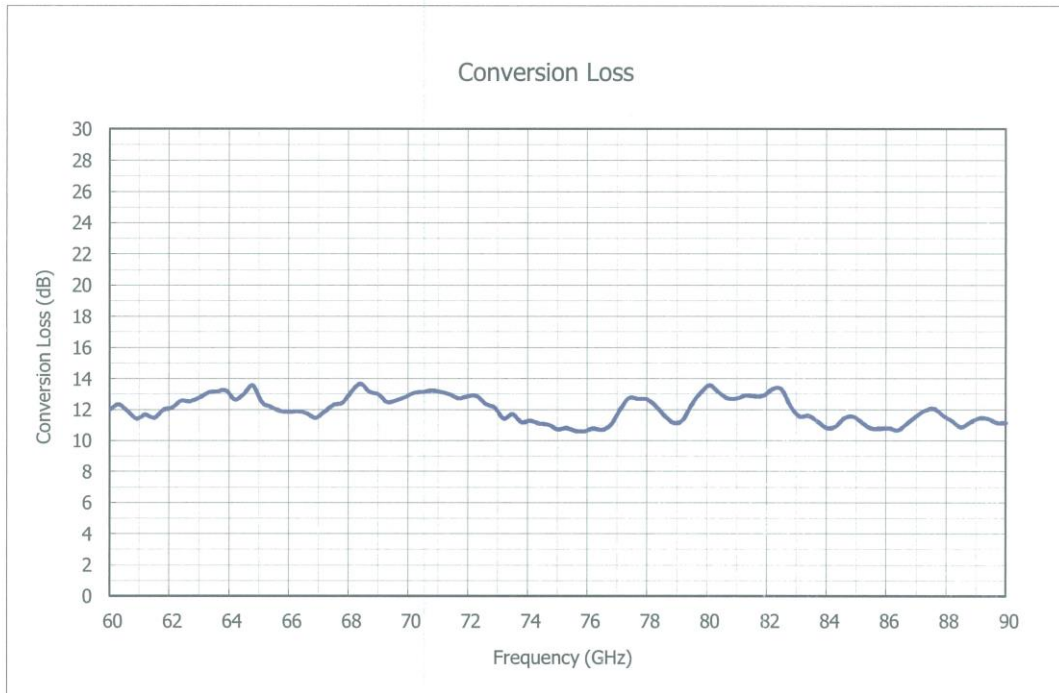

[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022667

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025660

페이지(page) : 3 of 4

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
60.0	11.98	0.82	71.1	13.13	0.82
60.3	12.32	0.82	71.4	12.97	0.82
60.6	11.91	0.82	71.7	12.70	0.82
60.9	11.41	0.82	72.0	12.85	0.82
61.2	11.66	0.82	72.3	12.85	0.82
61.5	11.46	0.82	72.6	12.34	0.82
61.8	11.97	0.82	72.9	12.11	0.82
62.1	12.13	0.82	73.2	11.41	0.82
62.4	12.56	0.82	73.5	11.68	0.82
62.7	12.53	0.82	73.8	11.18	0.82
63.0	12.76	0.82	74.1	11.27	0.82
63.3	13.08	0.82	74.4	11.08	0.82
63.6	13.16	0.82	74.7	11.02	0.82
63.9	13.23	0.82	75.0	10.72	0.82
64.2	12.63	0.82	75.3	10.80	0.82
64.5	13.00	0.82	75.6	10.61	0.82
64.8	13.55	0.82	75.9	10.60	0.82
65.1	12.46	0.82	76.2	10.77	0.82
65.4	12.16	0.82	76.5	10.69	0.82
65.7	11.91	0.82	76.8	11.03	0.82
66.0	11.84	0.82	77.1	11.99	0.82
66.3	11.87	0.82	77.4	12.72	0.82
66.6	11.74	0.82	77.7	12.67	0.82
66.9	11.46	0.82	78.0	12.64	0.82
67.2	11.85	0.82	78.3	12.20	0.82
67.5	12.28	0.82	78.6	11.55	0.82
67.8	12.43	0.82	78.9	11.13	0.82
68.1	13.14	0.82	79.2	11.34	0.82
68.4	13.65	0.82	79.5	12.33	0.82
68.7	13.15	0.82	79.8	13.08	0.82
69.0	12.98	0.82	80.1	13.56	0.82
69.3	12.47	0.82	80.4	13.09	0.82
69.6	12.58	0.82	80.7	12.71	0.82
69.9	12.79	0.82	81.0	12.70	0.82
70.2	13.07	0.82	81.3	12.90	0.82
70.5	13.13	0.82	81.6	12.85	0.82
70.8	13.21	0.82	81.9	12.89	0.82

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022667

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025660

페이지(page) : 4 of 4

2. Conversion Loss Data (cont.)

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
82.2	13.32	0.82	86.4	10.67	0.82
82.5	13.29	0.82	86.7	11.09	0.82
82.8	12.19	0.82	87.0	11.55	0.82
83.1	11.55	0.82	87.3	11.92	0.82
83.4	11.59	0.82	87.6	12.03	0.82
83.7	11.22	0.82	87.9	11.58	0.82
84.0	10.81	0.82	88.2	11.25	0.82
84.3	10.90	0.82	88.5	10.86	0.82
84.6	11.43	0.82	88.8	11.16	0.82
84.9	11.53	0.82	89.1	11.42	0.82
85.2	11.13	0.82	89.4	11.40	0.82
85.5	10.78	0.82	89.7	11.13	0.82
85.8	10.77	0.82	90.0	11.13	0.82
86.1	10.78	0.82	-	-	-

끝.

열 람 용

This certificate may not be reproduced
other than in full except with
permission of the issuing laboratory.

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022665
교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025658

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415877

- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR8.0
- 기기번호 (Serial Number) : SAX779

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2023.03.14

차기교정예정일자 : 2024.03.14
(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.9 ± 0.4) °C - 습도(Humidity) : (46 ± 2) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT/E8257D	MY46130629	2023/10/26	(주)에이치시티
EPM SERIES POWER METER	AGILENT/E4419B	GB42420565	2023/10/26	(주)에이치시티
POWER SENSOR	KEYSIGHT/W8486A	MY56370005	2024/01/10	Keysight Technologies
WR-08 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S08MS-A	160419-1	2023/09/05	(주)에이치시티
PAX SIGNAL ANALYZER	AGILENT/N9030A	U551350310	2024/03/13	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty)

: 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, $k = 2$ (Confidence level about 95 %, $k = 2$)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	(서명)	승인자 (Approved by)	(서명)
	성명 (Name) 고 형 재		직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager)	
			성명 (Name) 김 광 철	

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2023. 03. 15

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



※ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

※ 고객전용사이트(<http://www.callab.co.kr>)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT




성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022665

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025658

페이지(page) : 2 of 3

1. Conversion Loss Graph

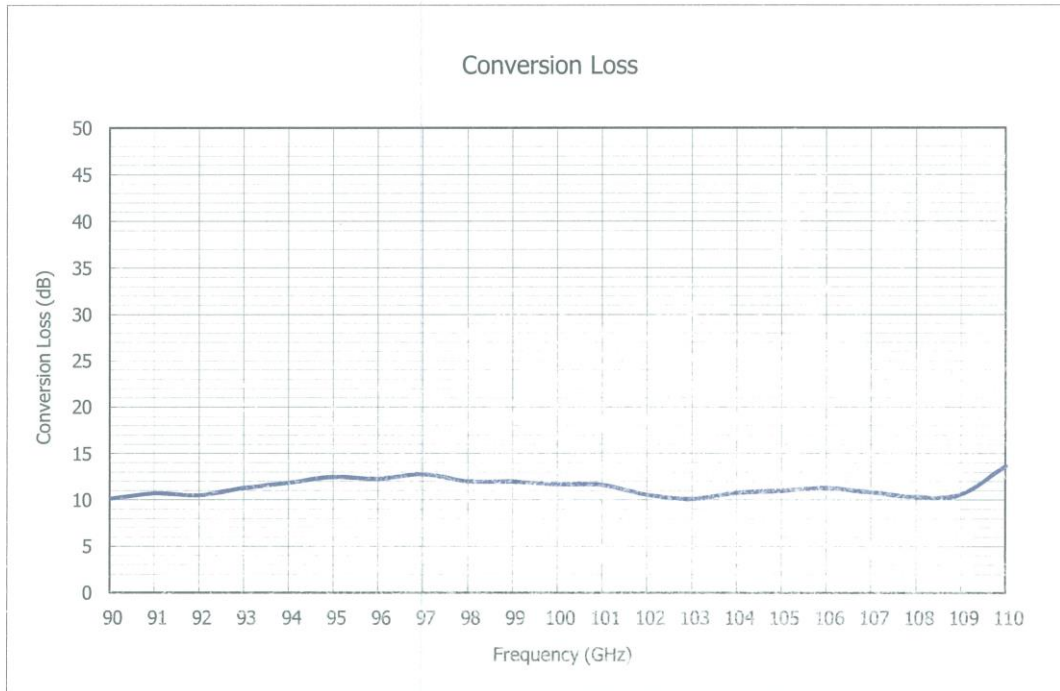

[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA

F-02P-02-008 (Rev.02)

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2023-022665

교 정 번 호(Calibration No) : C-2023-025658

페이지(page) : 3 of 3

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
90.0	10.09	0.82	101.0	11.59	0.82
91.0	10.68	0.82	102.0	10.55	0.82
92.0	10.50	0.82	103.0	10.08	0.82
93.0	11.26	0.82	104.0	10.73	0.82
94.0	11.82	0.82	105.0	10.99	0.82
95.0	12.44	0.82	106.0	11.26	0.82
96.0	12.25	0.82	107.0	10.81	0.82
97.0	12.74	0.82	108.0	10.30	0.82
98.0	11.99	0.82	109.0	10.57	0.82
99.0	11.95	0.82	110.0	13.62	0.82
100.0	11.67	0.82	-	-	-

끝.

열 램 용

This certificate may not be reproduced
other than in full except with
permission of the issuing laboratory.

Measurement Report

74, Seoicheon-ro 578beon-gil, Majang-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea 17383
Tel : 82-31-645-6900, www.hct.co.kr

보고서번호(Report No) : IC-2023-022669
측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025662

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 대상품목 (Measurement Item)

◇ HCT 등록번호 : 416612

- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR8.0
- 기기번호 (Serial Number) : SAX779

3. 측정일자 (Measurement date) : 2023.03.14

4. 측정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.7 ± 0.4) °C - 습도(Humidity) : (47 ± 4) % R.H.

5. 측정방법 (Measurement method used)

상기기기는 고객의 요구사항에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 점검되었
음.

측정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT/E8257D	MY46130629	2023/10/26	(주)에이치시티
PAX SIGNAL ANALYZER	AGILENT/N9030A	US51350310	2024/03/13	(주)에이치시티
ERICKSON POWER METER	VDI/PM5	394V	Not calibrated	(주)에이치시티
WR-08 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S08MS-A	160419-1	Not calibrated	(주)에이치시티

6. 측정결과 (Measurement result)

: 측정결과 참조 (Refer to attachment)

(주) 이 측정결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

The measurement results shown in this report refer only to the sample(s) measured unless otherwise stated.

확 인 (Affirmation)	작성자 (Tested by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) : 고 형 재	직위 (Title) 기술책임자(Technical Manager) 성명 (Name) 김 광 철

이 성적서는 ILAC MRA 서명 기관인 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)와 A2LA (American Laboratory for Laboratory Accreditation)의 인정
과 무관합니다. This calibration certificate is Not an accredited report by KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) and A2LA(American Association
for Laboratory Accreditation), a ILAC MRA signatory.

2023. 03. 15

HCT

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



(주) 측정결과는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. If any significant instability
or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.

F-02P-02-010 (Rev.01)


Measurement Result

보고서번호(Report No) : IC-2023-022669

페이지(page) : 2 of 3

측정번호(Measurement No) : C-2023-025662

1. Conversion Loss Graph

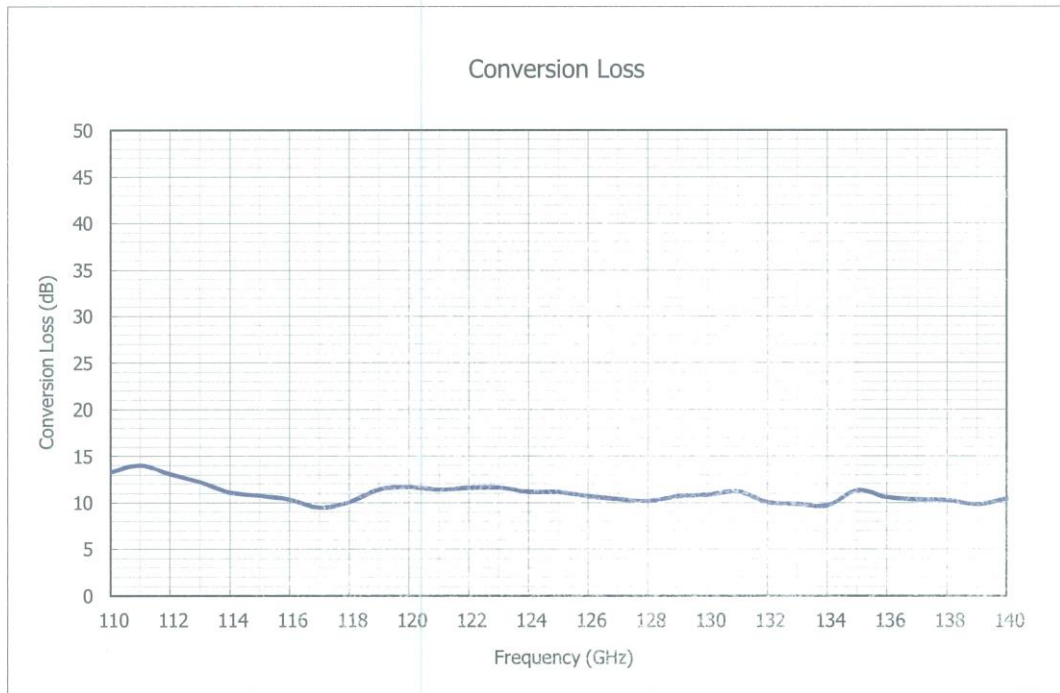

[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. In the absence of power standards above 110 GHz, power measurements above 110 GHz are to confirm operation functionality and traceable only to HCT.
3. The above results were measured at the request of the customer.

F-02P-02-010 (Rev.01)

Measurement Result

보고서번호(Report No) : IC-2023-022669

페이지(page) : 3 of 3

측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025662

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)
110.0	13.28	126.0	10.68
111.0	13.99	127.0	10.38
112.0	13.05	128.0	10.16
113.0	12.18	129.0	10.68
114.0	11.10	130.0	10.84
115.0	10.74	131.0	11.19
116.0	10.34	132.0	10.05
117.0	9.47	133.0	9.87
118.0	10.07	134.0	9.72
119.0	11.41	135.0	11.31
120.0	11.67	136.0	10.58
121.0	11.39	137.0	10.36
122.0	11.58	138.0	10.29
123.0	11.60	139.0	9.84
124.0	11.15	140.0	10.41
125.0	11.12	-	-

끝.

열 램 용

This certificate may not be reproduced
other than in full except with
permission of the issuing laboratory.

Measurement Report

74, Seoicheon-ro 578beon-gil, Majang-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea 17383
Tel : 82-31-645-6900, www.hct.co.kr

보고서번호(Report No) : IC-2023-022666

페이지(page) : 1 of 4

측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025659

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 대상품목 (Measurement Item)

◇ HCT 등록번호 : 415876

- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR5.1
- 기기번호 (Serial Number) : SAX774

3. 측정일자 (Measurement date) : 2023.03.14

4. 측정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.8 ± 0.4) °C
- 습도(Humidity) : (49 ± 4) % R.H.

5. 측정방법 (Measurement method used)

상기기기는 고객의 요구사항에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 점검되었음.

측정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR	AGILENT/E8257D	MY46130629	2023/10/26	(주)에이치시티
PAX SIGNAL ANALYZER	AGILENT/N9030A	US51350310	2024/03/13	(주)에이치시티
ERICKSON POWER METER	VDI/PM5	394V	Not calibrated	(주)에이치시티
WR-05 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S05MS-A	160419-1	Not calibrated	(주)에이치시티

6. 측정결과 (Measurement result)

: 측정결과 참조 (Refer to attachment)

(주) 이 측정결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

The measurement results shown in this report refer only to the sample(s) measured unless otherwise stated.

확 인 (Affirmation)	작성자 (Tested by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) : 고 형 재	직위 (Title) 기술책임자(Technical Manager) 성명 (Name) 김 광 철

이 성적서는 ILAC MRA 서명 기관인 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)와 A2LA (American Laboratory for Laboratory Accreditation)의 인정과 무관합니다. This calibration certificate is Not an accredited report by KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) and A2LA(American Association for Laboratory Accreditation), a ILAC MRA signatory.

2023. 03. 15

HCT

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.

Ⓜ 측정결과는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.

F-02P-02-010 (Rev.01)


Measurement Result

보고서번호(Report No) : IC-2023-022666

페이지(page) : 2 of 4

측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025659

1. Conversion Loss Graph

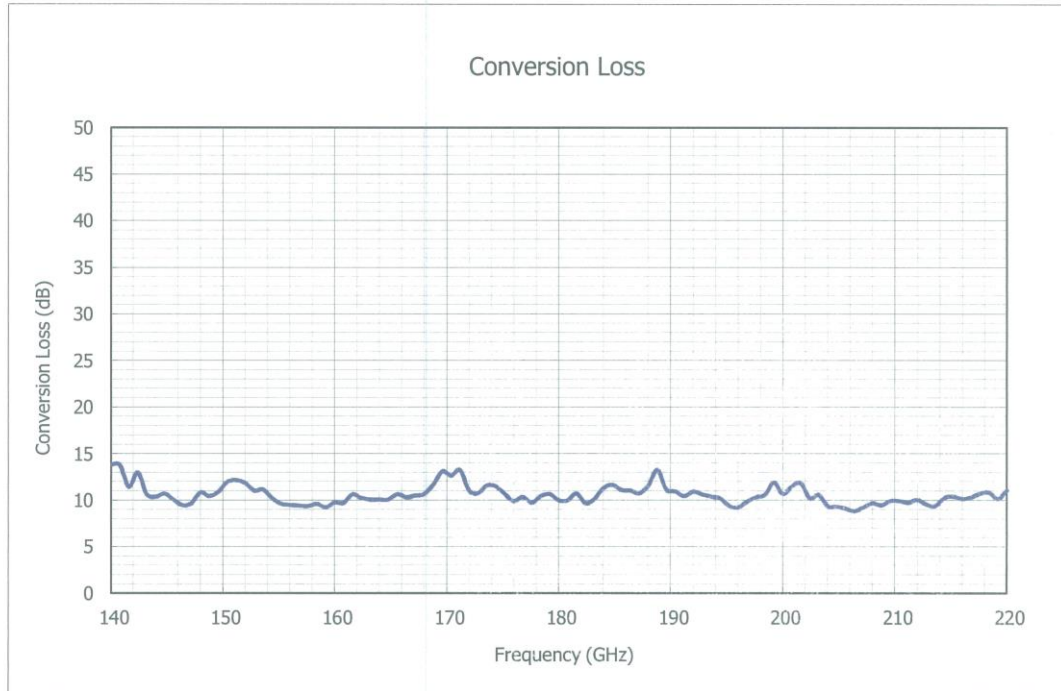

[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 24, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. In the absence of power standards above 110 GHz, power measurements above 110 GHz are to confirm operation functionality and traceable only to HCT.
3. The above results were measured at the request of the customer.

F-02P-02-010 (Rev.01)

Measurement Result

보고서번호(Report No) : IC-2023-022666

페이지(page) : 3 of 4

측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025659

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)
140.0	13.81	169.6	13.06
140.8	13.76	170.4	12.60
141.6	11.41	171.2	13.19
142.4	12.96	172.0	11.02
143.2	10.62	172.8	10.72
144.0	10.37	173.6	11.55
144.8	10.70	174.4	11.44
145.6	10.05	175.2	10.63
146.4	9.46	176.0	9.88
147.2	9.65	176.8	10.33
148.0	10.81	177.6	9.71
148.8	10.43	178.4	10.42
149.6	10.89	179.2	10.64
150.4	11.94	180.0	9.98
151.2	12.12	180.8	9.97
152.0	11.82	181.6	10.70
152.8	11.02	182.4	9.66
153.6	11.13	183.2	10.12
154.4	10.22	184.0	11.28
155.2	9.61	184.8	11.61
156.0	9.47	185.6	11.08
156.8	9.41	186.4	11.01
157.6	9.35	187.2	10.70
158.4	9.58	188.0	11.55
159.2	9.23	188.8	13.22
160.0	9.74	189.6	11.12
160.8	9.69	190.4	10.90
161.6	10.62	191.2	10.42
162.4	10.21	192.0	10.89
163.2	10.04	192.8	10.60
164.0	10.04	193.6	10.37
164.8	10.06	194.4	10.17
165.6	10.62	195.2	9.39
166.4	10.29	196.0	9.21
167.2	10.48	196.8	9.82
168.0	10.65	197.6	10.30
168.8	11.64	198.4	10.56

F-02P-02-010 (Rev.01)

Measurement Result

보고서번호(Report No) : IC-2023-022666

페이지(page) : 4 of 4

측 정 번 호(Measurement No) : C-2023-025659

2. Conversion Loss Data (cont.)

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)
199.2	11.87	210.4	9.88
200.0	10.64	211.2	9.72
200.8	11.46	212.0	10.02
201.6	11.79	212.8	9.54
202.4	10.17	213.6	9.36
203.2	10.55	214.4	10.21
204.0	9.34	215.2	10.38
204.8	9.31	216.0	10.11
205.6	9.08	216.8	10.28
206.4	8.81	217.6	10.69
207.2	9.23	218.4	10.80
208.0	9.66	219.2	10.12
208.8	9.44	220.0	11.02
209.6	9.90	-	-

끝.