
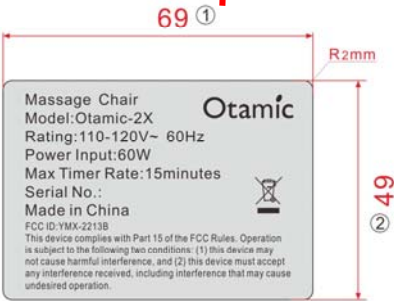


Label and label location

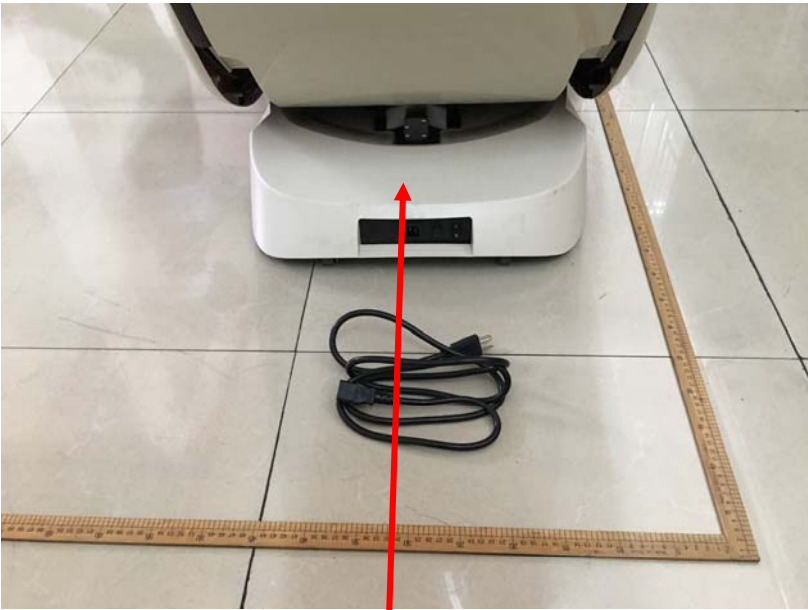

■ black

- 技术要求：
- 1.材质使用银底PC背油胶,表面覆光膜，厚度 $0.25 \pm 0.05\text{mm}$ ；
 - 2.套印、冲裁居中，无毛边；
 - 3.高湿温测试（温度 60°C 、湿度93%环境下48小时）不起翘、不收缩；
 - 4.用沾有汽油的棉布以15N的力对表面文字擦拭15S后无异常；
 - 5.未注公差 $\pm 0.5\text{mm}$.

| | | | | | | | |
|------|------|------|----|----|------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | 名 称 | 后盖标 |
| | | | | | | 结构图号 | |
| 标记处数 | 更改内容 | 更改文件 | 签名 | 日期 | 外观图号 | RD-08-OGI2213B-TIT-000006-10 | |
| 设 计 | | 标准化 | | | 比例 | 结构版本 | G2.01.20.PRI2213B-00 |
| 确 认 | | | | | | 1.0 | |
| 审 核 | | | | | | | |
| 工 艺 | | 批 准 | | | 共1张 | 第1张 | 奥佳华智能健康设备 |